

Dental CAD CAM Fair 2023 in 宮崎

最新の口腔内スキャナーをご覧いただける場を設けました。

現状の口腔内スキャナーの応用は、印象採得・補綴・インプラント・カウンセリングなど多岐にわたります。

今回はUKデンタル・シロナ・モリタ合同企画として、現状の口腔内スキャナーの可能性を訴求させていただきます。

口腔内スキャナーを導入することで、チェアタイムの削減や質の高い治療を提供できます。

是非この機会に口腔内スキャナーの可能性をご覧いただけたらと思います。

開催
日時

2023年

6月21日(水)・22日(木) 13:00~20:00

会場

株式会社UKデンタル 宮崎店
2階 UKホール

主催

株式会社UKデンタル 宮崎店



共催展示メーカー 展示メーカーの商品に関する最新情報は各社HPをご覧ください。



Dentsply
Sirona

デンツプライシロナ株式会社
<https://www.dentsplysirona.com>



株式会社モリタ

<https://japan.morita.com/>

お申込み先


株式会社UKデンタル
宮崎店

TEL: 0985-35-6533

FAX: 0985-35-6544

| | |
|-----------|--|
| 貴医院名 | フリガナ |
| | お名前 |
| ご住所 〒 | TEL |
| | FAX |
| | E-mail @ |
| 参加人数 名 | ご来場日時 |
| | 21日 <input type="checkbox"/> 13時 <input type="checkbox"/> 14時 <input type="checkbox"/> 15時 <input type="checkbox"/> 16時 <input type="checkbox"/> 17時 <input type="checkbox"/> 18時 <input type="checkbox"/> 19時 22日 <input type="checkbox"/> 13時 <input type="checkbox"/> 14時 <input type="checkbox"/> 15時 <input type="checkbox"/> 16時 <input type="checkbox"/> 17時 <input type="checkbox"/> 18時 <input type="checkbox"/> 19時 |

Dental CAD CAM Fair 2023 in 宮崎

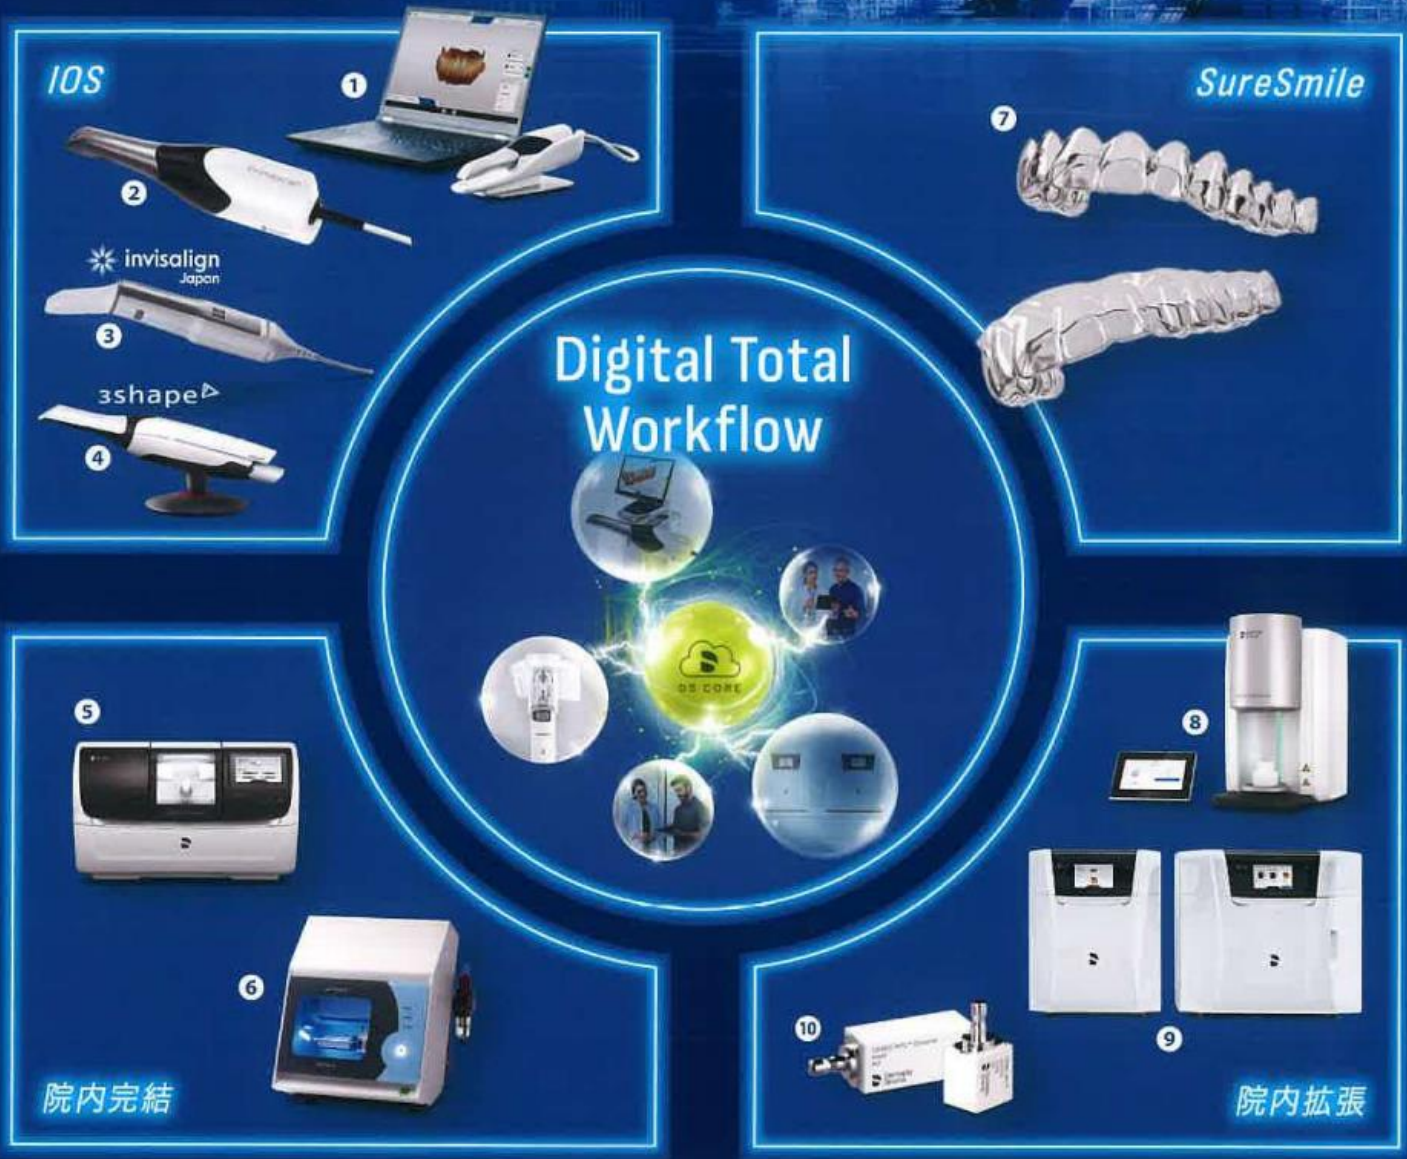

院内完結

院内拡張

- ① プライムスキャン コネクト
- ② セレック プライムスキャンAC
- ③ iTeroエレメント
- ④ TRIOS 4 オーラルスキャナシステム
- ⑤ セレック プライムミル
- ⑥ 歯科用CAD/CAMマシン DWX-4
- ⑦ SureSmileソフトウェア
- ⑧ セレック スピードファイア
- ⑨ プライムプリント
- ⑩ セレックMTLジルコニア

セレック プライムスキャン AC チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号:130100BZX00044000 クラス分類:II (標準・特許)
 iTeroエレメント デジタル印象取得装置 承認番号:22900BZX00222000 クラス分類:II (標準・特許)
 TRIOS 4 オーラルスキャナシステム デジタル印象取得装置 承認番号:30200BZ100027000 クラス分類:II (標準・特許)
 セレック プライムミル 歯科技工室用型コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号:13B1X10236S10022 クラス分類:I (一般)
 歯科用CAD/CAMマシン DWX-4 歯科技工室用型コンピュータ支援設計・製造ユニット 承認番号:22B3X100050000050 クラス分類:I (一般)
 SureSmileソフトウェア 歯科矯正用治療支援プログラム 承認番号:30100BZX00187000 クラス分類:II (特許)
 Essix Plasticシート 歯科矯正用レジジン材料 承認番号:225AKBZX00098000 クラス分類:II (特許)
 セレックスピードファイア 歯科技工用ポーセレン焼成炉 製造番号:13B1X10236S10009 クラス分類:I (一般)
 プライムプリント 歯科技工室用型コンピュータ支援設計・製造ユニット 院内機器届出番号:13B1X10236S10023 クラス分類:I (一般)
 プライムプリントPPU 歯科技工用射出装置 医療機器届出番号:13B1X10236S10024 クラス分類:I (一般)
 セレック MTL ジルコニア 歯科切削加工用セラミックス 承認番号:304AGBZ100007000 クラス分類:II (標準)
 アクセオス アーム型X線CT診断装置 医療機器届出番号:302AK6ZX00062000 クラス分類:II (標準・特許・特許)

NEW DS Core

DS Coreから始まる
無限の可能性。

あらゆる診療ワークフローをサポートする
デジタルユニバースを形成。
シームレス、コラボレーション、効率化、迅速、
それは全ての治療結果のために。